PMV3

Caractéristiques techniques

Usage prévu	Dentisterie Conservatrice et Restauratrice	
Indications d'emploi	Finition des traitements par facettes céramiques	
Description	Cuillère interne diamantée pour le placement des lignes de finition en interproximal permettant un axe d'insertion rotationnel pour la facette	
Type d'insert	Diamanté	
Facteur allergisant	Insert fabriqué avec un acier inoxydable chirurgical conforme à la norme ASTM F899 - 12b L'acier chirurgical inoxydable contient : • Nickel • Chrome L'alliage du liant de sertissage du diamantage contient : • Nickel	
Référence commerciale	PMV3 : F02023	
Classe médicale	Le dispositif médical est classé IIa selon la directive européenne 93/42/CEE.	

Réglages	Gamme Newtron	Gamme P5	Suprasson P5 Booster	Prophy Max - P-Max - Implant Center 2 - Piezotome 2	Irrigation
	15	15	10	5	

Durée de vie

Parce qu'il n'est pas possible d'établir un nombre maximum d'utilisations, pouvant être fonction de nombreux paramètres tels que la durée d'utilisation, la dureté de l'émail, l'effort exercé ou l'usure, nous vous recommandons de renouveler au minimum une fois par an les dispositifs médicaux couramment utilisés. Procédez au renouvellement du dispositif médical si l'insert ne vibre pas à la fréquence attendue, le traitement ne se déroule pas comme d'habitude et prend plus de temps ou ne progresse pas.

Documentations liées

Nom du document	Références
Mode de consultation des instructions d'emploi électroniques	J00000
Protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des inserts	J02000
Fiche clinique Kit PerfectMargin Veneers	J08100
Tableau de réglage de puissance des générateurs à ultrasons	J58000
Notice générale relative à l'ensemble de la gamme des inserts dentaires conventionnels	J02100

Ce document est le document original, rédigé en Français.
Référence J00650 version V1 et numéro de plan NT15FR040A.

Stérilisation

NON STERILE

Stériliser avant utilisation



Vous devez désinfecter, nettoyer et stériliser l'insert avant et après chaque utilisation. Avant toute utilisation, référez-vous aux Protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des inserts J02000.

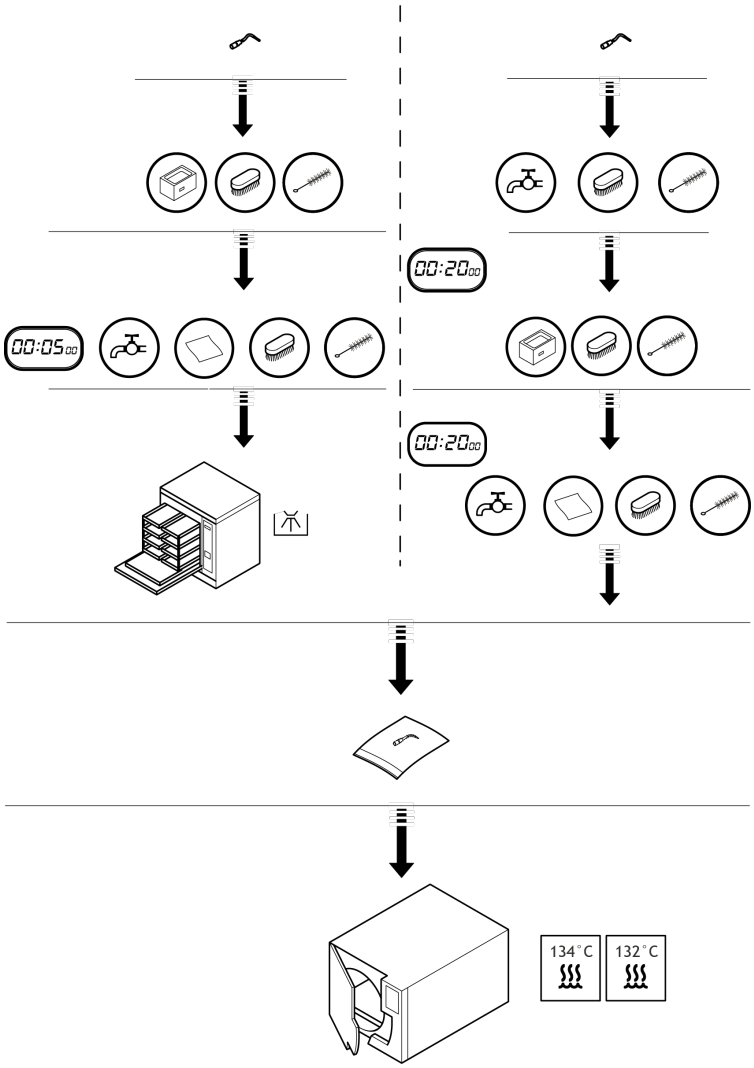

Mise en place

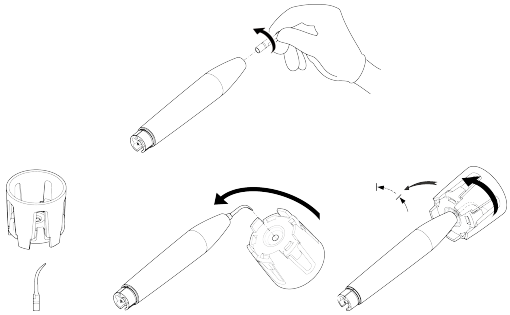

Démontage

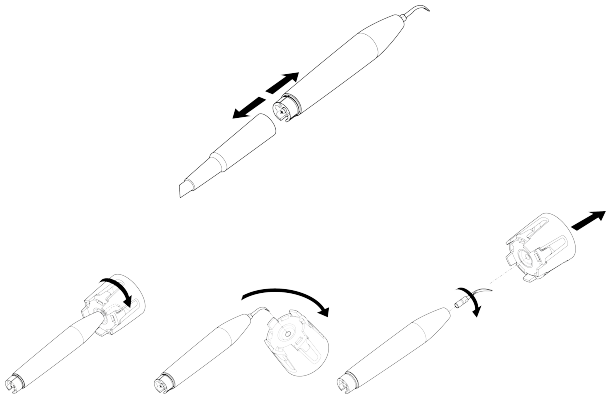

Identification du fabricant

SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
France
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E.mail : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

Date de première apposition de marquage CE

2013

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCE
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail : satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use

ACTEON