TKW4 II

Tekniske specifikationer

Forudset anvendelse	Osteotomi
Indikationer for brug	Sekundær boring
Beskrivelse	Cylindrisk insert med en flad diamanteret ende til forberedelse af knogle-receptaklet (før løft af membranen) og udvidelse af adgangskanalen til sinus-membranen
Type insert	Diamanteret
Allergifremkaldende faktor	Insert fremstillet i rustfrit stål til medicinsk brug i overensstemmelse med standarden ASTM F899 - 12b Rustfrit stål til medicinsk brug indeholder: • Nikkel • Krom Legeringen til diamanteringens indfatning indeholder: • Nikkel
Varenummer	TKW4 II: F87534
Klasse for medicinsk udstyr	Dette medicinske udstyr er af klasse IIa iht. det europæiske direktiv 93/42/EØF.

Indstillinger	Generatorer	Maksimal mode	Maksimal finindstilling	Skylning
	Implant Center II Piezotome II Piezotome Cube Piezotome Solo	D2	3	100 ml/min.

Levetid

Da det ikke er muligt at bestemme et maksimalt antal anvendelser, som kan afhænge af mange forskellige parametre såsom brugsvarighed, vævenes hårdhed, den udøvede styrke eller slitage, anbefaler vi at udskifte hyppigt anvendt medicinsk udstyr mindst en gang om året. Udskift det medicinske udstyr, hvis inserten vibrerer ikke ved den forventede frekvens, behandlingen foregår ikke som sædvanlig og tager længere tid eller skrider ikke fremad.

Tilknyttet dokumentation

Dokumentnavn	Referencer
Funktion med konsultation af elektroniske brugsanvisninger	J00007
Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af inserts	J02029
Klinisk datablad Intralift	J57321
Skema med indstillingsværdier for effekt af ultralyd-generatorerne beregnet til intraoral kirurgi	J58010
Generel vejledning til hele udvalget af inserts til tandkirurgi	J87329

Dette dokument er oversat fra originalen, som er på fransk.
Reference J01140 version V2 og nummer på tegning NO50FR190B.

Sterilisation

Skal steriliseres før brug



Inserten skal desinficeres, rengøres og steriliseres efter hver brug. Før enhver brug, se protokoller for rengøring, desinfektion og sterilisation af inserts J02029.

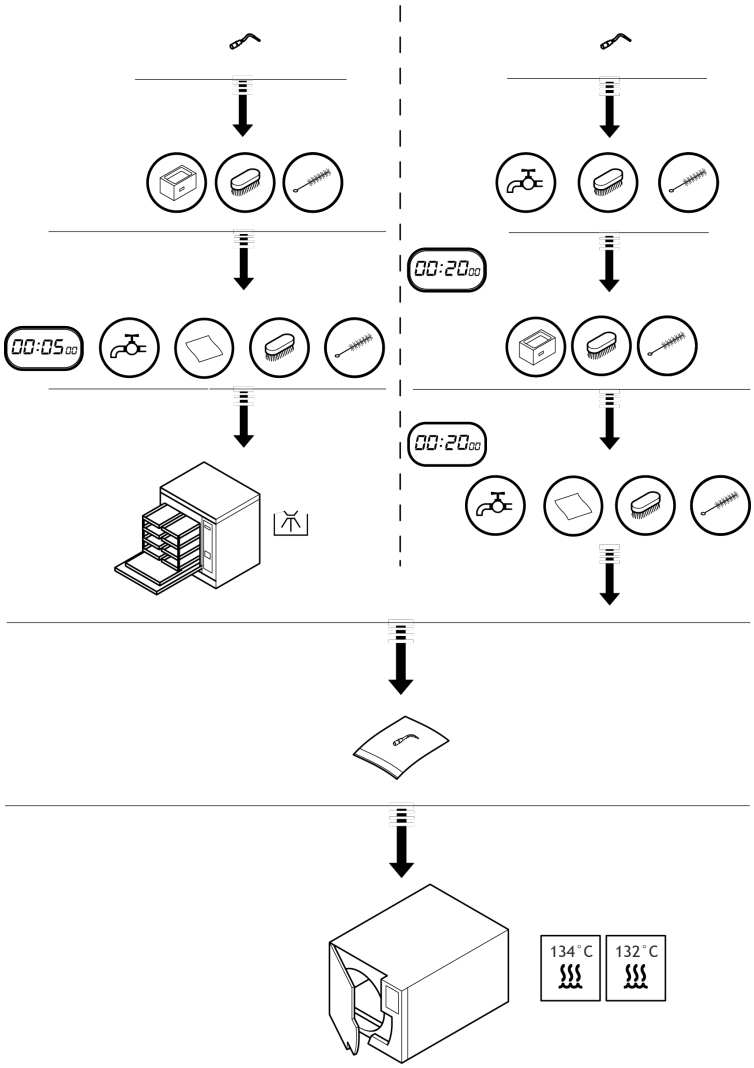

Isætning

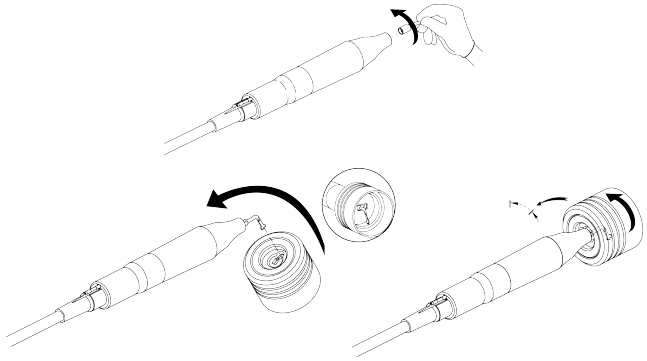

Afmontering

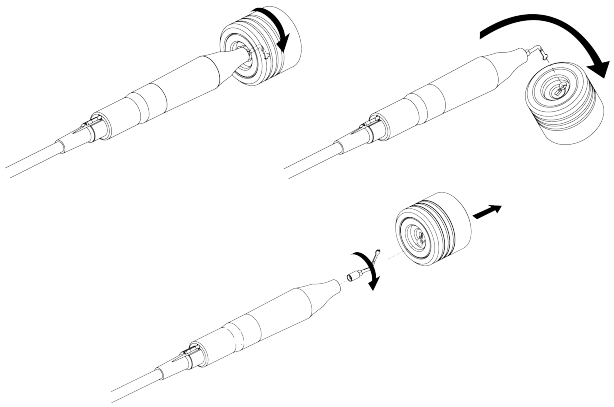

Identifikation af fabrikanten

SATELEC
En virksomhed i ACTEON Gruppen
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Frankrig
Tlf. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

Dato for første tildeling af EU-mærkning

2009

Insert | TKW4 II | J89141 | (09) | V2 | 09/2017 | NO50DA190B

SATELEC S.A.S. | En virksomhed i ACTEON Gruppen
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANKRIG
Tlf. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use

ACTEON