10X

Caratteristiche tecniche

Utilizzo previsto	Detartarizzazione	
Indicazioni d'uso	Ablazione del tartaro sopragengivale	
Descrizione	Ablazione del tartaro degli spazi interprossimali	
Tipo di punta	Liscio	
Fattore allergizzante	Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b L'acciaio chirurgico inossidabile contiene: • Nichel • Cromo	
Riferimento commerciale	10X : F00359	
Classe medicale	Il dispositivo medicale è classificato IIa secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.	

Regolazioni	Gamma Newtron	Gamma P5	Suprasson P5 Booster	Prophy Max - P-Max - Implant Center 2 - Piezotome 2	Irrigazione
	12	12	9	2	

Durata di vita

Non essendo possibile stabilire un numero massimo di utilizzi, che possono dipendere da numerosi parametri come la durata di utilizzo, la durezza dei tessuti, lo sforzo esercitato o l'usura, vi raccomandiamo di sostituire almeno una volta l'anno i dispositivi medicali abitualmente utilizzati. Procedere al rinnovo del dispositivo medicale se la punta non vibra alla frequenza prevista, il trattamento non si svolge come al solito e richiede più tempo, oppure non progredisce.

Documentazioni associate

Nome del documento	Riferimenti
Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche	J00007
Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte	J02002
Scheda clinica Ablazione del tartaro	J08012
Tabella di regolazione di potenza dei generatori a ultrasuoni	J58000
Manuale generale relativo alla gamma completa di punte dentali convenzionali	J02100

Questo documento è la traduzione in italiano della versione originale redatta in
Riferimento J00150 versione V2 e numero di schema NB01FR410B.

Sterilizzazione

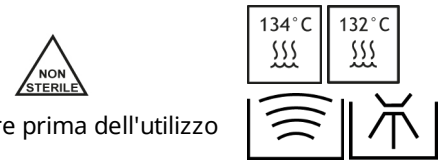

Sterilizzare prima dell'utilizzo

È necessario disinfettare, pulire e sterilizzare la punta prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, consultare i Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte J02002.

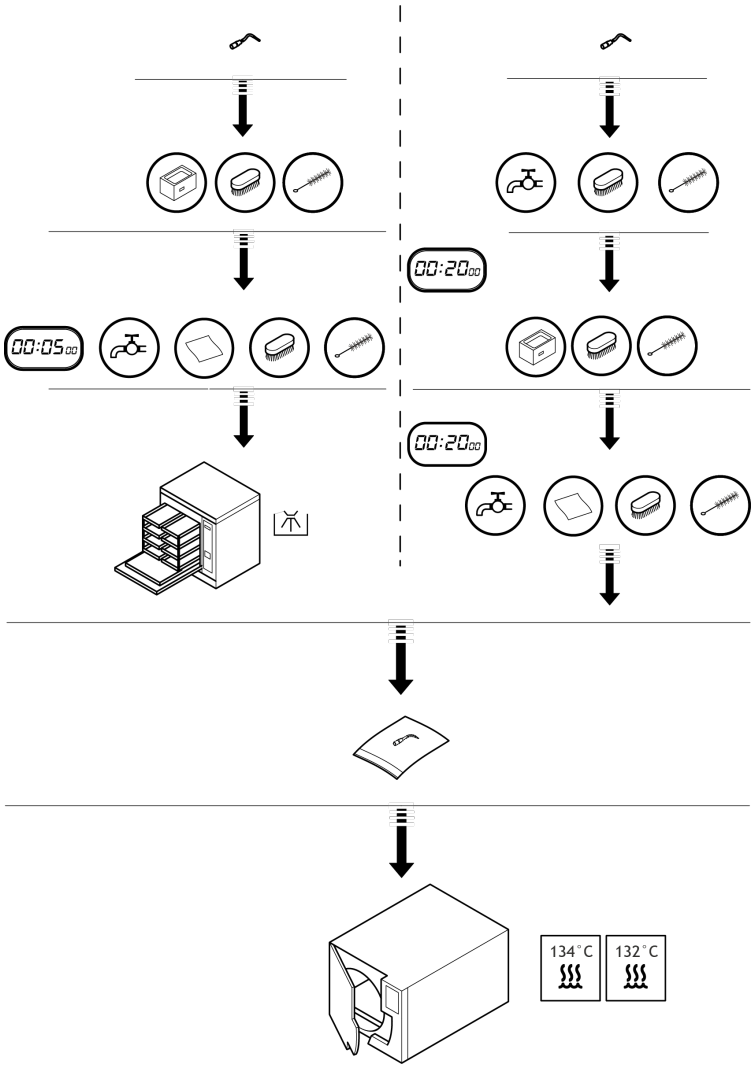

Il medico deve visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio di

Posizionamento

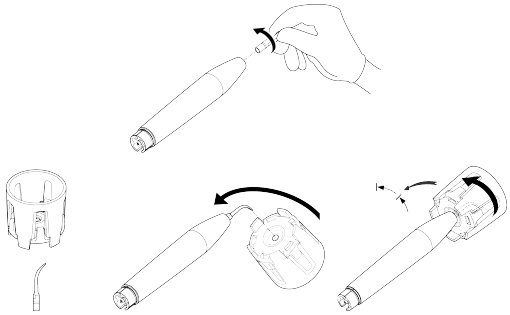

Smontaggio

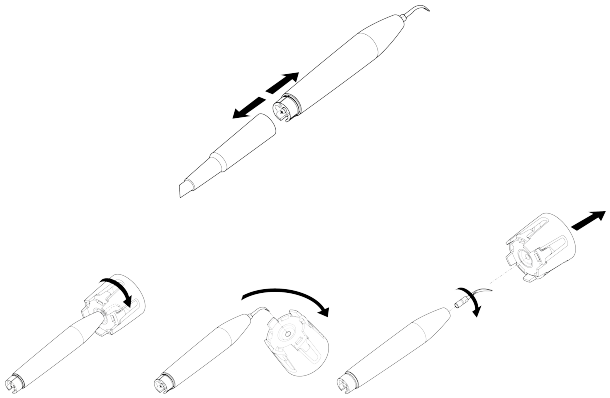

Identificazione del fabbricante

SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

Data di prima apposizione della marcatura CE

1998

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCIA
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use

ACTEON