H2R

Caratteristiche tecniche

Utilizzo previsto	Parodontologia	
Indicazioni d'uso	Sbrigliamento parodontale e trattamento superficiale radicolare.	
Descrizione	Punta diamantata di trattamento superficiale dei settori premolare e molare, orientata a destra, complementare alla punta H2L, per il trattamento delle forcazioni, degli spazi stretti e degli ascessi	
Tipo di punta	Diamantato	
Fattore allergizzante	Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b L'acciaio chirurgico inossidabile contiene: • Nichel • Cromo La lega del legante di aggraffatura della diamantatura contiene: • Nichel	
Riferimento commerciale	H2R : F00368	
Classe medicale	Il dispositivo medicale è classificato IIa secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.	

Regolazioni	Gamma Newtron	Gamma P5	Suprasson P5 Booster	Prophy Max - P-Max - Implant Center 2 - Piezotome 2	Irrigazione
	2	2	1	2	

Durata di vita

Non essendo possibile stabilire un numero massimo di utilizzi, che possono dipendere da numerosi parametri come la durata di utilizzo, la durezza dei tessuti, lo sforzo esercitato o l'usura, vi raccomandiamo di sostituire almeno una volta l'anno i dispositivi medicali abitualmente utilizzati. Procedere al rinnovo del dispositivo medicale se la punta non vibra alla frequenza prevista, il trattamento non si svolge come al solito e richiede più tempo, oppure non progredisce.

Documentazioni associate

Nome del documento	Riferimenti
Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche	J00007
Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte	J02002
Scheda clinica Parodontologia	J08022
Tabella di regolazione di potenza dei generatori a ultrasuoni	J58000
Manuale generale relativo alla gamma completa di punte dentali convenzionali	J02100

Questo documento è la traduzione in italiano della versione originale redatta in
Riferimento J00190 versione V2 e numero di schema NB12FR020B.

Sterilizzazione

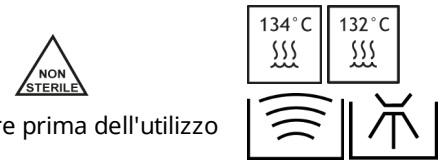

Sterilizzare prima dell'utilizzo

È necessario disinfettare, pulire e sterilizzare la punta prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, consultare i Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte J02002.

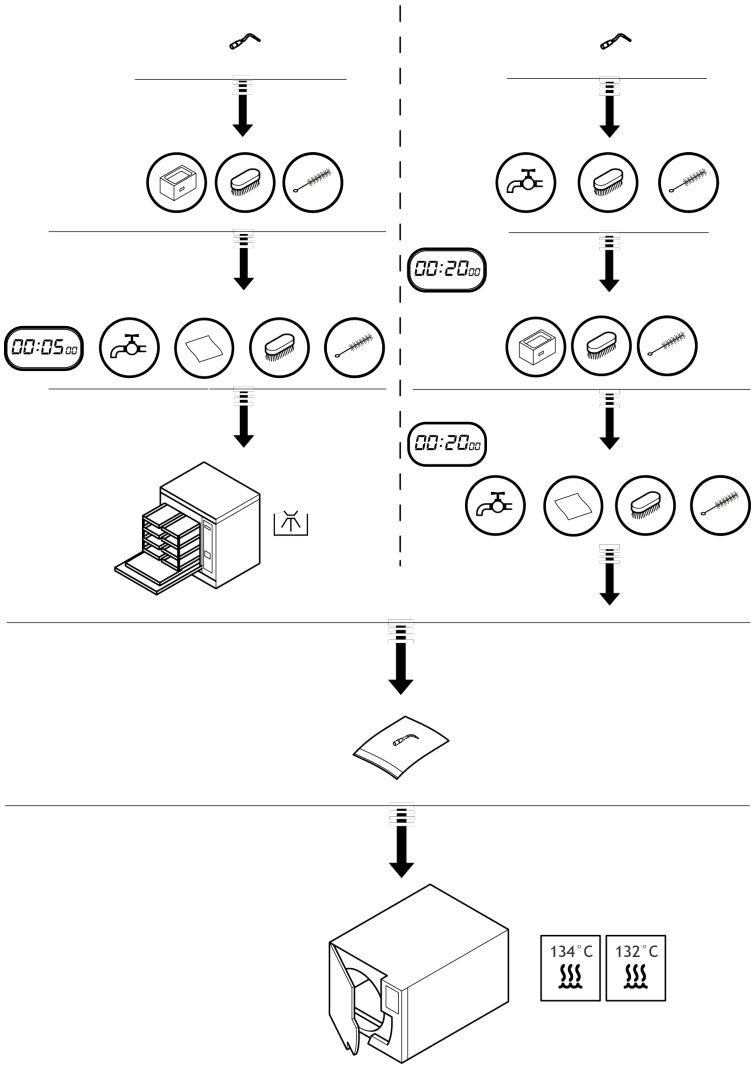

Il medico deve visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio di

Posizionamento

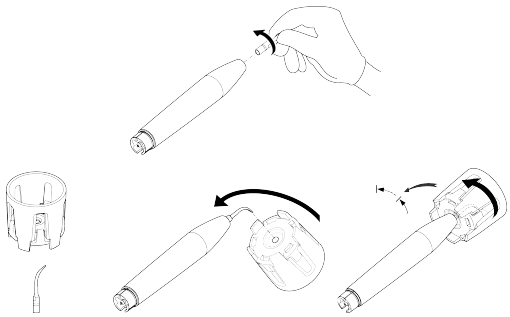

Smontaggio

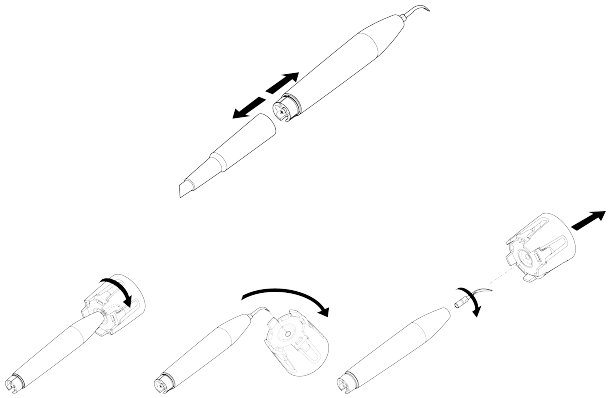

Identificazione del fabbricante

SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

Data di prima apposizione della marcatura CE

1998

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCIA
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use

ACTEON