

## Caratteristiche tecniche

Utilizzo previsto	Osteotomia			
Indicazioni d'uso	Osteotomia			
Descrizione	Punta marcata ogni 2 mm, complementare alla punta CS1 II, per la realizzazione del secondo tratto di taglio fino a circa 8 mm di profondità			
Tipo di punta	Scalpello			
Fattore allergizzante	Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b  L'acciaio chirurgico inossidabile contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nichel</li> <li>• Cromo</li> </ul>			
Riferimento commerciale	CS2 II : F87562			
Classe medicale	Il dispositivo medicale è classificato IIa secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.			
Regolazioni	Generatori	Modalità massima	Regolazione fine massima	
	Implant Center II Piezotome 2 Piezotome Cube Piezotome Solo LED	Mandibola D2 Mascellare D3	1-3	80-100 ml/min

## Durata di vita

Non essendo possibile stabilire un numero massimo di utilizzi, che possono dipendere da numerosi parametri come la durata di utilizzo, la durezza dei tessuti, lo sforzo esercitato o l'usura, vi raccomandiamo di sostituire almeno una volta l'anno i dispositivi medicali abitualmente utilizzati. Procedere al rinnovo del dispositivo medicale se la punta non vibra alla frequenza prevista, il trattamento non si svolge come al solito e richiede più tempo, oppure non progredisce.


## Documentazioni associate

Nome del documento	Riferimenti
Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche	J00007
Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte	J02002
Scheda clinica Crest Splitting	J57332
Tabella di regolazione di potenza dei generatori a ultrasuoni per la chirurgia intra-orale	J58010
Manuale generale relativo all'intera gamma delle punte dentali chirurgiche	J87302


## Sterilizzazione




Sterilizzare prima dell'utilizzo




È necessario disinfettare, pulire e sterilizzare la punta prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, consultare i Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte J02002.

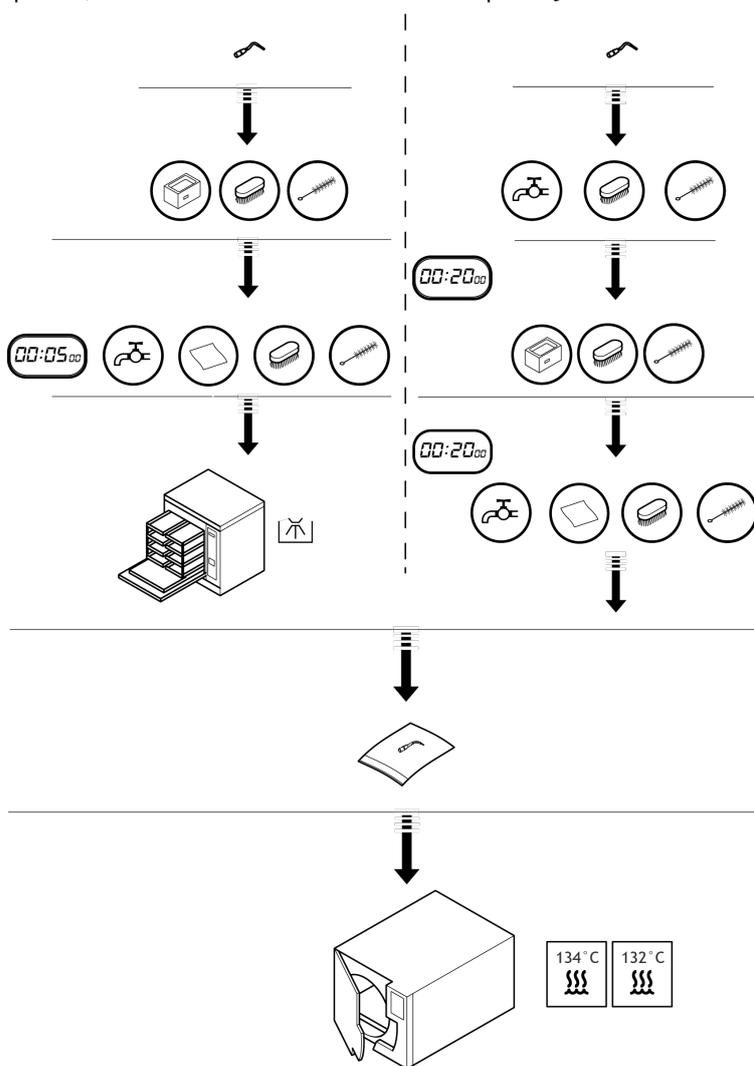

## Posizionamento

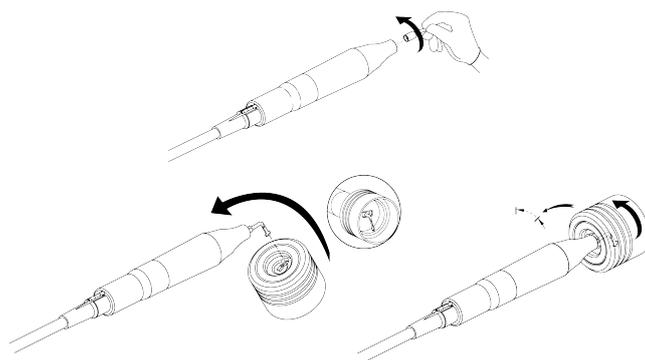

## Smontaggio

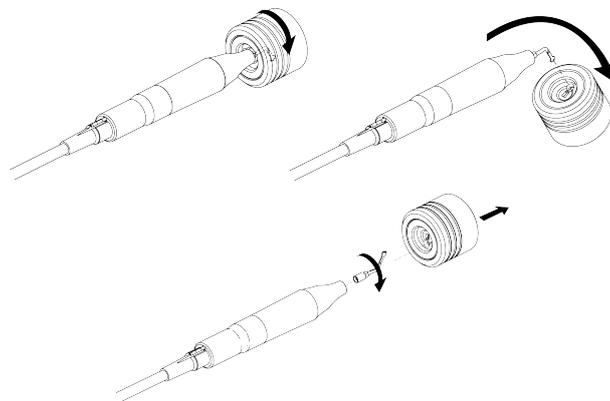

## Identificazione del fabbricante



SATELEC  
A Company of ACTEON Group  
17, avenue Gustave Eiffel  
BP 30216  
33708 MERIGNAC cedex  
Francia  
Tel. +33 (0) 556.34.06.07  
Fax. +33 (0) 556.34.92.92  
E-mail: [satelec@acteongroup.com](mailto:satelec@acteongroup.com)  
[www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)



## Data di prima apposizione della marcatura CE

2011



Il medico deve visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio di

Punta | CS2 II | J01252 | (11) | V3 | 05/2018 | NO50IT300C

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group  
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCIA  
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92  
E-mail: [satelec@acteongroup.com](mailto:satelec@acteongroup.com) | [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)

Download



Instructions For Use

