CS2 II

Технические характеристики

Надлежащее использование	Остеотомия	
Указания по использованию	Остеотомия	
Описание	Насадка с маркировкой через каждые 2 мм (маркировка отмечает рекомендованную глубину погружения), дополняющая насадку CS1 II, для проведения второго разреза на глубину до 8 мм	
Тип насадки	Скальпель	
Аллергический фактор	Насадка из нержавеющей хирургической стали соответствует стандарту ASTM F899 - 12b В состав нержавеющей хирургической стали входят: • никель • хром	
Торговый артикул	CS2 II : F87562	
Класс медицинского аппарата	В соответствии с требованиями директивы Европейского союза 93/42/CEE данный медицинский аппарат имеет класс IIa.	

Настройки	Генераторы	Максимальный режим	Максимальная тонкая регулировка	Ирригация
	Implant Center II Piezotome 2 Piezotome Cube Piezotome Solo LED	Нижняя челюсть D2 Верхняя челюсть D3	1-3	80-100 мл/мин

Срок службы

Так как не представляется возможным определить максимальное число возможных процедур, потому что их число зависит от продолжительности использования, твердости зубной эмали, прилагаемых усилий и износа, мы рекомендуем вам менять наиболее часто используемые медицинские аппараты один раз в год. Следует заменить медицинский аппарат, если вибрация насадки не соответствует заданной частоте, аппарат работает неправильно, процедура занимает больше времени, чем обычно, или результат не достигается.

Сопутствующие документы

Наименование документа	Ссылка
Способ просмотра электронных инструкций	J00007
Протоколы очистки, дезинфекции и стерилизации насадок	J02019
Технологическая карта Crest Splitting (Расщепление гребня)	J02251RU
Таблица регулировки мощности ультразвуковых генераторов, используемых в хирургии полости рта.	J58010
Общая инструкция для всех видов стоматологических хирургических насадок	J87339

Данный документ представляет собой перевод на русский язык оригинального
Номер J01250 редакция V3 и номер чертежа NO50FR300C

Стерилизация

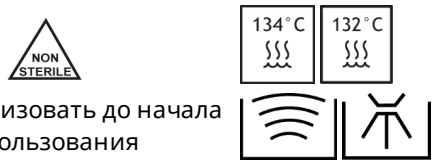

Простерилизовать до начала использования

Необходимо очистить, дезинфицировать и стерилизовать насадку до и после каждого использования. Перед каждым использованием сверьтесь с протоколом очистки, дезинфекции и стерилизации насадок J02019.

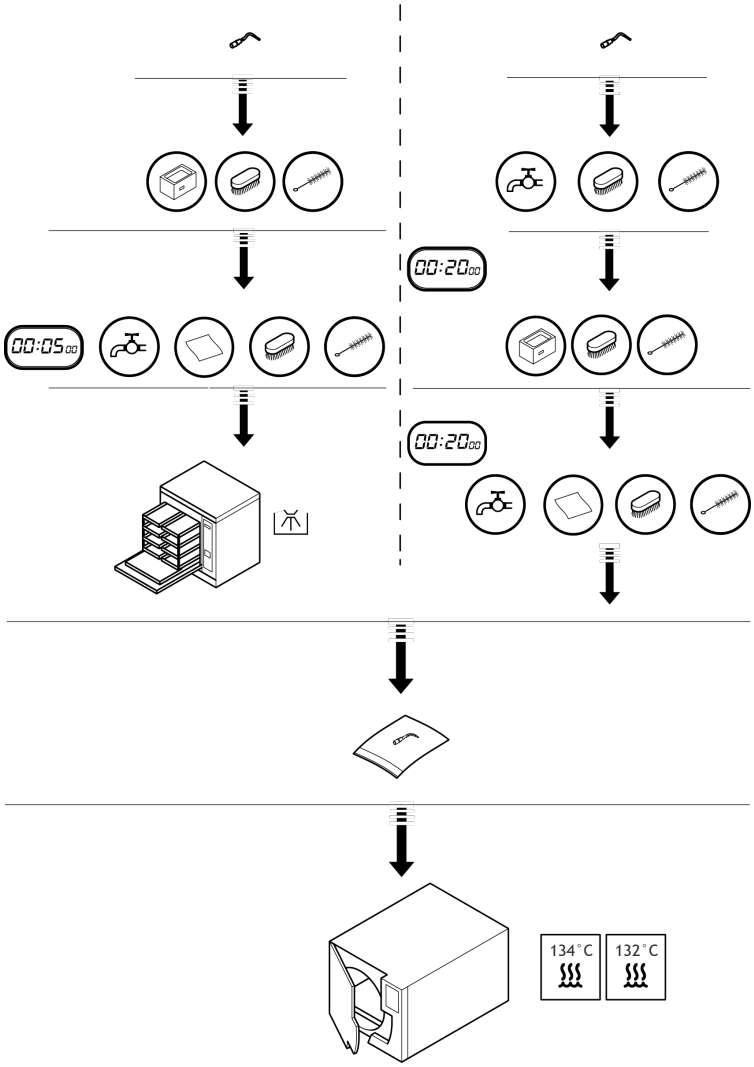

Врач постоянно должен держать в поле зрения место, на котором производится вмешательство, чтобы сразу

Установка

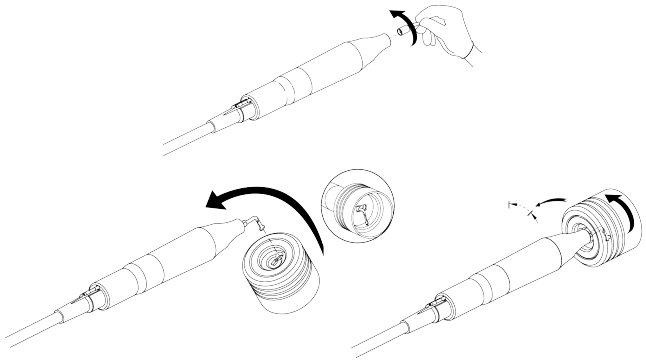

Демонтаж

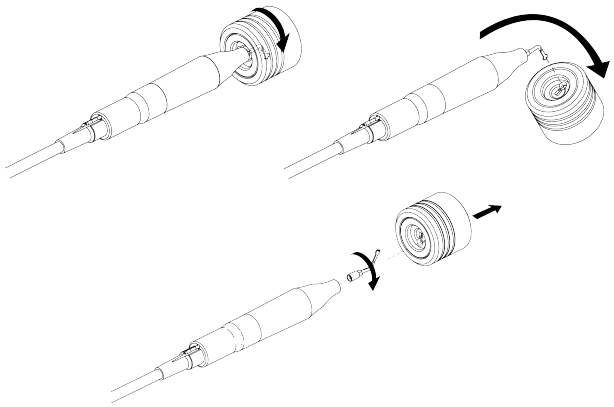

Сведения о производителе

SATELEC
A Company of ACTEON Group
авеню Гюстав Эйфель, д. 17 (17, avenue Gustave Eiffel)
П/Я 30216
33708 МЕРИНЬЯК (33708 MERIGNAC cedex)
Франция
Тел.: +33 (0) 556 34 06 07
Факс +33 (0) 556 34 92 92
E.mail : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

Дата первого нанесения маркировки CE

2011

АО упрощенного типа SATELEC|A Company of ACTEON Group
авеню Гюстав Эйфель, д. 17 (17, avenue Gustave Eiffel)|П/Я 30216
ФРАНЦИЯ
Тел.: +33 (0) 556 34 06 07|Факс +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com|www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use

ACTEON